



SE136IC2

Rilevatore IR di CO₂ con uscita a Relè
IR CO₂ Gas Detector with with output relay
Détecteur ponctuel IR pour gaz CO₂

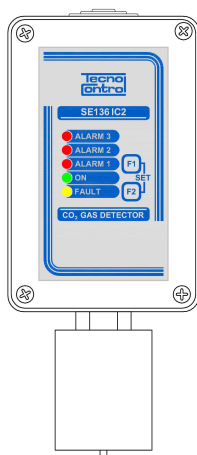

Leggere attentamente e Conservare quest'Istruzione.
Please read and keep this manual
Lire avec soin et garder la notice d'instruction

Per cinque anni non è necessario effettuare la calibrazione del sensore.
For five years it is not necessary to calibrate the sensor.
Pendant cinq ans, ne est pas nécessaire d'étalonner le capteur.

Modello / Model / Modele	Calibrato per / Calibrated for / Tarée pour
SE136 IC2	Anidride carbonica / Carbon Dioxide / dioxyde de carbone

Caratteristiche tecniche / Technical specifications / Caractéristiques techniques

Alimentazione / Power supply / Alimentation	12÷24Vcc (-10/+15%) 2,5W / 12÷24Vdc (-10/+15%) 2.5W
Sensore / Sensor Type / Capteur	NDIR (Nondispersive Infrared Sensor)
Uscite / Outputs / Sortie	4 relè / relays / relais 24V/1A SPST 4 ÷ 20 mA lineare / Linear / linéaire
Resistenza di carico / load resistor / résistance de charge	50 ohm / 12Vdc (-10%) - 500 ohm / 24Vdc (-10%)
Campo di misura / Standard Range / Champ de mesure	0 ÷ 2 % vol (=20000 ppm)
Vita media in aria / Average Life in air / Vie moyenne en air	MTBF (Sensore / Sensor / Capteur) > 5 anni / years / ans
Tempo di risposta / Response Time / Temps de réponse	60s < T ₉₀ < 105s (dipendente dal valore misurato / depending on the measured value / dépend de la valeur mesurée)
Ripetibilità di zero / Zero Repeatability / Zéro répétitivité	±1% FS (Fondo Scala / Full Scale / fond d'échelle)
Precisione / Accuracy / Précision	±0,02%vol (=200ppm) + 5% del valore misurato / of measuring value / de la valeur mesurée
Tempo di Preriscaldamento / Warm up time / Temps de préchauffage	< 60 sec - Funzionamento / operational / fonctionnement < 5 min - a specifiche / Full specification / Stabilité
Risoluzione / Resolution / résolution	0,01 %vol (=100 ppm)
Linearità / Linearity / Linéarité	± 1.5% FS
Deriva a lungo termine in aria / Long time drift in air / Dérive à long terme en air	0,002%vol (=20 ppm) anno / year / an
Tempo massimo di immagazzinamento / Max Storage Time / Temps maximum de stockage	1 anno / year / an
Temp./umidità di immagazzinamento / Storage Temp-Humidity / Température et hygrométrie de stockage	-40 ÷ +60°C / 5÷95 % RH non condensata / non condensed / non condensée
Temp./umidità di funzionamento / Operation Temp./Humidity / Température et hygrométrie de fonctionnement	-20 ÷ +55 °C / 10÷90 % RH non condensata / non condensed / non condensée
Pressione / Operation Pressure / Pression de fonctionnement	85 – 110 kPa
Grado di protezione -Dimensioni – Peso / IP Code - Size – Weight / Indice de protection - Dimensions du boîtier - poids	IP44 / 160 x 80 x 67 mm / 450g

(IT) DESCRIZIONE	2
NOTE SUI VARI MODELLI	2
FUNZIONAMENTO	2
INSTALLAZIONE	3
AVVERTENZE	3
VERIFICHE	3
(EN) DESCRIPTION	4
NOTES ON THE AVAILABLE MODELS	4
OPERATIONAL DESCRIPTION	4
INSTALLATION	5
WARNING	6
TESTS	6
(FR) DESCRIPTION	6
NOTES SUR LES DIFFERENTS MODELES	7
FONCTIONNEMENT	7
AVERTISSEMENTS	8
VERIFICATIONS	8

IT DESCRIZIONE

Gli **SE136 IC2** sono rilevatori di **Anidride carbonica (CO₂)**, con sensore "**Infrarosso**" (**NDIR – Nondispersive Infrared Sensor**), utilizzati in sistemi centralizzati d'allarme per laboratori, industrie alimentari (Cantine, Birrerie) o ambienti (Serre) dove controllare la quantità di anidride carbonica presente. Il rilevatore è costituito da una custodia che contiene il circuito elettronico e i morsetti di collegamento. Il sensore è all'interno del portasensore, posto nella parte inferiore della custodia.

I rilevatori **SE136 IC2** hanno 3 relè d'allarme impostabili in %vol come indicato in [Tabella 2](#). I relè, sigillati, hanno un contatto libero da tensione, impostabili tramite Dip-Switch NA oppure NC.

Inoltre è disponibile un segnale d'uscita (**S**) 4÷20mA lineare, utilizzabile per collegare una centrale remota.

Sul coperchio sono posti i tasti F1 e F2 per le operazioni di verifica, utilizzabili solo tramite codice, e i 3 Led che indicano le condizioni di funzionamento.

3° Led Rosso "ALARM 3":	Relè d'allarme ALARM 3.
2° Led Rosso "ALARM 2":	Relè d'allarme ALARM 2.
1° Led Rosso "ALARM 1":	Relè d'allarme ALARM 1.
LED verde "ON":	Funzionamento normale.
LED giallo "FAULT":	Sensore guasto o scollegato o scaduto.

NOTE SUI VARI MODELLI

Il modello **SE136 IC2** è tarato con fondo scala di **2%vol (= 20000ppm) di CO₂**.

L'**Anidride carbonica** (sinonimo: biossido di carbonio), è un gas inodore, incolore, più pesante dell'aria, la sua densità relativa all'aria è 1,5 e per questo può accumularsi in basso causando una pericolosa carenza di ossigeno. Il suo **TWA è 5000ppm=0,5%vol** (Time-Weighted Average) e lo **STEL è 15000 ppm=1,5%Vol** (Short Term Exposure Limit).

L'anidride carbonica è una componente fondamentale dell'atmosfera terrestre, nell'aria pulita è circa 400 ppm ed è necessaria ai processi vitali delle piante (fotosintesi) e degli animali, ma per l'atmosfera terrestre è anche un gas serra. L'anidride carbonica viene prodotta da processi di combustione del petrolio e del carbone fossile (centrali termoelettriche e autoveicoli), è un sottoprodotto della fermentazione (vino, birra e sostanze organiche), oppure è emessa da processi naturali e da esalazioni dal suolo. Viene utilizzata nel settore agricolo o florovivaistico per aumentare la crescita delle piante tramite aumento della sua concentrazione nelle serre, ecc.

FUNZIONAMENTO

Il sensore NDIR è compensato in temperatura, può essere utilizzato in ambienti inquinati senza avere un degrado sensibile delle prestazioni anche a lungo termine e funziona anche in ambienti con carenza di ossigeno.

Il principio di funzionamento del sensore NDIR si basa sul principio fisico che alcuni tipi di gas assorbono determinate lunghezze d'onda di energia infrarossa. In pratica un filamento genera l'energia a infrarossi, che concentrata passa attraverso il gas da misurare e arriva al rivelatore. Il rivelatore è doppio: il primo, definito "attivo", ha un filtro ottico per il gas da misurare, mentre il secondo, chiamato "riferimento" ha un filtro con una lunghezza d'onda differente. Il rilevatore attivo viene usato per rilevare il gas, mentre il rivelatore di riferimento fornisce il valore di "zero". La differenza di segnale tra i due rivelatori fornisce il valore di concentrazione di gas. Il vantaggio di questa tecnica è che è selettiva soprattutto per gas come l'anidride carbonica, che è difficile da misurare con altri sistemi ed inoltre ha il vantaggio di compensare i cambiamenti che si verificano nella sensibilità del rilevatore con il tempo. L'unica causa di interferenza può essere dato dalla presenza di vapore acqueo che assorbe l'infrarosso.

Preriscaldamento: quando il rilevatore è alimentato, inizia la fase di preriscaldamento del sensore, segnalata dal lampeggio del LED giallo "FAULT". Dopo circa 60 secondi, il LED giallo si spegne e si accende quello verde "ON", che indica il normale funzionamento. Dopo questo tempo il sensore è in grado di rilevare il gas, ma raggiunge le condizioni di stabilità ottimali dopo 10÷30 minuti di funzionamento continuo (solo dopo questo tempo si possono fare le verifiche).

Funzionamento Normale: deve essere acceso il solo LED verde (ON).

Allarmi: i 3 livelli d'allarme, utilizzando i Dip-Switch, possono essere impostati con diverse combinazioni, in funzione del modello, ([Vedi Tabella 2](#)). Con il funzionamento normale, i relè intervengono con ritardi fissi. Con la funzione TLV-TWA, STEL e C, i relè intervengono, senza ritardi, quando è superato il relativo livello d'allarme.

Il 1° Led rosso (ALARM 1) si accende se la concentrazione di gas supera il 1° livello d'allarme impostato. Il relè ALARM 1 interviene: dopo 12 secondi con le impostazioni normali, mentre con le impostazioni avanzate interviene senza ritardi, quando è superato il livello TLV-TWA.

Il 2° Led rosso (ALARM 2) si accende se la concentrazione di gas supera il 2° livello d'allarme impostato. Il relè ALARM 2 interviene dopo 30 secondi oppure immediatamente quando è superato il livello TLV-STEL.

Il 3° Led rosso (ALARM 3) si accende se la concentrazione di gas supera il 3° livello d'allarme impostato. Il relè ALARM 3 interviene dopo 60 secondi oppure immediatamente quando è superato il livello TLV-C.

I **TLV** (threshold limit values) sono i valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti a cui i lavoratori possono essere esposti ogni giorno per tutta la durata della vita lavorativa senza effetti nocivi.

TLV-TWA (time weighted average) è il limite medio ponderato nel tempo ovvero la concentrazione media ponderata nel tempo per una normale giornata lavorativa di 8 ore ed una settimana lavorativa di 40 ore, cui i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti nocivi.

TLV-STEL (short time exposure limit) è il limite d'esposizione nel breve periodo ovvero la concentrazione cui i lavoratori possono essere esposti continuamente per 15 minuti, senza subire irritazioni, danni cronici, irreversibili o narcosi.

TLV-C (Ceiling) è il Limite massimo di concentrazione che non deve mai essere superata.

I valori indicati sono riferiti alle prescrizioni degli enti che si occupano della salute dei lavoratori, lo statunitense OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*) e l'europeo COSHH (*Control Of Substances Hazardous to Health*).

Guasti: quelli possibili, sotto elencati, sono indicati dall'accensione del Led giallo (FAULT). L'uscita "S" va a 0mA. Viene attivato il relè FAULT che è *normalmente eccitato con un contatto NC libero da tensione*. Se richiesto, il relè può essere utilizzato per segnalare a distanza la condizione di guasto e/o la mancanza d'alimentazione.

Il LED giallo si accende ogni 3 secondi (con il LED verde acceso): per avvisare che il "Sensore" ha superato il suo limite di vita (circa 5 anni) e non è più garantito il suo corretto funzionamento. Il rilevatore continua a funzionare normalmente, ma è necessario, al più presto, sostituire e/o inviare il rilevatore al fornitore per sostituire il "Sensore".

Il LED giallo è acceso e il verde è spento (relè "FAULT" attivato e uscita 0mA): questo indica più possibilità di guasto. **1)** la configurazione dei Dip Switch non è corretta, verificarne la posizione ([Vedi Tabella 2](#)). **2)** il "Sensore" è guasto (guasto del sensore o comunicazione assente o non corretta). Eseguite le verifiche, spegnere e riaccendere l'apparecchio. Se la condizione persiste, sostituire e/o inviare il rilevatore al fornitore per la riparazione.

Il LED giallo e il verde sono accesi (relè "FAULT" attivato e uscita 0mA): il "Sensore" è in blocco oppure è guasto. Spegnere e riaccendere l'apparecchio, se la condizione persiste, sostituire e/o inviare il rilevatore al fornitore per la riparazione.

INSTALLAZIONE

I rilevatori vanno installati, posizionati ed eseguite le manutenzioni seguendo tutte le norme nazionali vigenti per gli impianti elettrici e le norme di sicurezza degli impianti.

Montaggio: in [Fig. 1](#) sono indicate le dimensioni. Il rilevatore va installato verticale con il portasensore rivolto verso il basso.

Posizione dell'SE136 IC2: va fissato a circa 20-30 cm dal pavimento (il CO₂ è molto più pesante dell'aria).

Collegamenti elettrici (Fig.2): la distanza massima, cui può essere installato ogni singolo rivelatore dall'alimentatore è indicata nella [Tabella 1](#) in funzione della sezione del cavo. Nel caso d'alimentazione di più apparecchi in parallelo, è necessario calcolare la caduta di tensione sui tratti comuni dei cavi.

Normalmente è utilizzato un cavo (non schermato) a 2 conduttori per l'alimentazione + i conduttori per uscite relè.

NOTA: se si usa anche il segnale d'uscita in mA, usare cavi schermati a 3 conduttori + conduttori per uscite relè. La resistenza di carico massima con alimentazione 12Vcc (-10%) è 50ohm, mentre a 24Vcc (-10%) è 500ohm ([vedi Fig. 4](#)).

Il morsetto d'alimentazione (sulla scheda principale) è ad innesto, e va sfilato per collegare i cavi. Prestare attenzione nel reinserirlo dato che è polarizzato. Invece quelli dei Relè d'allarme, posti sulla scheda uscite, sono fissi. I relè, di tipo sigillato, hanno un contatto libero da tensione (SPST = 1 Singolo Contatto / Single Pole Single Throw) e possono essere impostati NA (Normalmente Aperto) o NC (Normalmente Chiuso) in base alla posizione del Dip-Switch n.4 ([vedi Tabella 3](#)). Con i Dip-Switch da 1 a 3 si determina anche a quali concentrazioni attivare gli allarmi. Alcuni allarmi hanno anche la funzione TLV-TWA e STEL ([Vedi Tabella 2](#)).

NOTA: I Dip-Switch vanno posizionati prima d'alimentare l'apparecchio. Se si utilizza l'apparecchio con i Dip-Switch in una posizione non permessa (riservata) verrà attivata l'indicazione di Guasto (vedi "Funzionamento > Guasti").

Importante: terminata l'installazione, alimentare l'apparecchio. Non è necessario effettuare nessuna regolazione, attendere circa 20÷30 minuti prima di effettuare, se richiesto, la "Verifica di funzionamento".

AVVERTENZE

La vita utile del sensore è mediamente superiore a 5 anni. Al termine di questo periodo, indicato dallo strumento con un lampeggio del LED giallo ogni 3 secondi, è necessario inviare il rilevatore al fornitore per sostituire il "Sensore". (Il lampeggio del Led è solo un avviso, il rilevatore continua a funzionare regolarmente).

Verifiche Periodiche: si consiglia di eseguire, in funzione dell'utilizzo, almeno ogni 6÷12 mesi la verifica di funzionamento del rilevatore, vedi la sezione "Verifiche". Per 5 anni non è necessario effettuare la calibrazione del sensore.

Nota: Il trasmettitore non è in grado di rivelare perdite che avvengono fuori dal locale in cui è installato o all'interno dei muri o sotto il pavimento.

ATTENZIONE: Considerare che in ambienti particolarmente inquinati o con Temperatura, Pressione o Umidità oltre i valori dichiarati, la vita utile del sensore può ridursi.

VERIFICHE

NOTA IMPORTANTE: le seguenti operazioni vanno eseguite da personale esperto e addestrato, in quanto, sono attivati i dispositivi d'allarme collegati alle uscite (relè e segnale in mA).

Test Elettrico e Verifica con Gas: per accedere a queste funzioni, è necessario inserire il relativo "Codice" con i pulsanti F1 e F2. Per far sì che la pressione sul pulsante sia riconosciuta, tenerlo premuto per circa un secondo (finché non si spegne un attimo il LED verde). Dopodiché si può passare al pulsante successivo. In caso d'errore basta aspettare circa 10 secondi e la sequenza è automaticamente cancellata.

Kit di prova e Bombole con Miscela Aria/Gas (Solo per Verifica) la miscela da utilizzare è:

Bombola di Gas Titolato per verifica della Taratura	Codice Bombola
1% Volume Anidride carbonica (CO ₂) in azoto	Fornibile a richiesta
Bombola di Gas Titolato per verifica di Zero	
Aria Zero Pura (con meno di 5 ppm CO ₂)	Fornibile a richiesta

È possibile usare **bombole monouso, complete di valvola d'erogazione**, inoltre è necessario usare il **kit di prova Tecnocontrol mod. TC011 oppure TC014**.

"TEST ELETTRICO" (Codice Test: **F2, F2, F1, F1**) permette di effettuare un test funzionale del rilevatore. Dopo aver messo l'impianto in sicurezza ed aver inserito il **"Codice Test"**, si spengono tutti i Led e si disattivano tutti i relè. Quindi si accenderanno in sequenza, i Led, dal giallo al 3° rosso. All'accensione dei Led corrisponde l'attivazione dei relativi relè (relè "FAULT" con il Led giallo, relè "ALARM1" con il 1° Led rosso, relè "ALARM2" con il 2° Led rosso, relè "ALARM3" con il 3° Led rosso). Alla fine, tutti i Led rimarranno accesi per 5 secondi, poi il rilevatore tornerà nelle condizioni di funzionamento normale. È consigliabile eseguire questo Test ogni 6-12 mesi in base all'utilizzo.

Nota: Non è possibile eseguire l'operazione se sono già accesi il **1° e/o il 2° e/o il 3° Led Rossi**.

"VERIFICA CON GAS" (Non serve Codice): serve per controllare la corretta risposta del rilevatore al gas e può essere eseguita dopo l'installazione, ma va eseguita soprattutto durante le manutenzioni periodiche.

NOTA: utilizzare la miscela di gas sopra indicata. Normalmente è sufficiente effettuare la **Verifica della Taratura**, (Bombola 1% Volume CO₂ in azoto) ma è possibile anche effettuare la **Verifica dello Zero** (Bombola Aria Zero).

Infilare il TC011/TC014 sul portasensore, regolare il riduttore della bombola in modo che il flussometro indichi da 0,3 l/min (vedi Fig. 3) Attendere circa 3 minuti e controllare che il rilevatore vada in allarme come descritto nel capitolo **"Funzionamento"**. Se il risultato fosse molto diverso, contattare il nostro servizio assistenza. Terminata la **"Verifica con Gas"**, chiudere la bombola, togliere il TC011. Considerare che progressivamente il rilevatore ritornerà alle condizioni normali.

NOTA: In aggiunta a quanto sopra, se si usa anche l'uscita in mA, Infilare il TC011/TC014 sul portasensore, regolare il riduttore della bombola in modo che il flussometro indichi 0,3 l/min (vedi Fig.3). Controllare, che con i puntali del voltmetro sui Test-Point **"TEST mV"** (TP1 e TP2), (vedi Fig.2) si raggiunga il valore in mV indicato in [Tabella 4-Colonna 6](#) [ovvero che l'uscita in mA aumenti fino al valore indicato nella [Colonna 7](#) ($\pm 0,56$ mA) e la centrale, cui è collegato il rilevatore, indichi il valore in indicato in [Colonna 8](#)]. Se il valore fosse molto diverso, contattare il nostro servizio assistenza. Terminata la **"Verifica"**, chiudere la bombola e allontanare il TC011/TC014. L'uscita tornerà poi a 4 mA.

Esempio se si deve verificare un SE136 IC2, utilizzando prima la bombola con Aria Zero Pura l'uscita in mA dovrà essere circa 4,0 mA (cioè circa 40mV su **"TEST mV"**), poi utilizzando la bombola con CO₂ a 1%vol (=10.000ppm) in Azoto, l'uscita in mA dovrà essere circa 12 mA ($\pm 0,56$ mA) (cioè 114÷126mV su **"TESTmV"**).

EN DESCRIPTION

The **SE136 IC2** series are gas detectors able to detect **CO₂ (Carbon Dioxide)** by employing a **NDIR – Non dispersive Infrared Sensor**, and find their best application in centralized alarm systems for laboratories, food industries (Wineries, Breweries) or environments (Greenhouses) where monitoring the amount of carbon dioxide.

The instruments is comprise of an enclosure in which the electronic circuit and the terminals are mounted; the sensor is inside the sensor holder, in the lower part of the housing.

The detector has three alarm levels, with different set-up as listed in [Table 2](#). The sealed relays are with tension free single pole contacts (SPST) and are also settable, NO or NC by the Dip-Switch.

The instrument has also a 4÷20mA linear output (**S**) connectable to a remote Gas Central Unit.

On the front panel, F1 and F2 key using for Test routine protected by a code and the 5 LED shows the functioning conditions.

3rd Red LED "ALARM 3":	3rd relay activation
2nd Red LED "ALARM 2":	2nd relay activation
1st Red LED "ALARM 1":	1st relay activation
Green LED "ON":	normal working condition
Yellow LED "FAULT":	the sensor should be faulty, disconnected or expired.

NOTES ON THE AVAILABLE MODELS

The **SE136 IC2** model is calibrated with a full scale of **2% volume (20000ppm) of CO₂**

The **Carbon dioxide** (synonym: Carbonic anhydride), is an odourless, colourless gas, heavier than air, its density relative to air is 1.5 and this gas can accumulate at the bottom causing a dangerous lack of oxygen. Its **TWA is 5000ppm = 0.5% volume** (Time-Weighted Average) and **STEL 15000ppm = 1.5% volume** (Short Term Exposure Limit).

Carbon dioxide is a fundamental component of Earth's atmosphere in clean air is about 400ppm and is necessary to the life processes of plants (photosynthesis) and animals, but, for the earth's atmosphere, it is also a greenhouse gas. The carbon dioxide is produced by combustion processes of petroleum and coal (thermal power plants and vehicles), as a by-product of fermentation (wine, beer and organic substances), or emitted by natural processes and by exhalations from the ground. Is used in agriculture or horticultural to increase the growth of plants, through increase of its concentration in greenhouses, etc.

OPERATIONAL DESCRIPTION

The NDIR sensor is temperature compensated, it can be used in polluted environments without a significant degradation of performance and also works in environments with oxygen deficiency.

The operational mode of the NDIR sensor is based on the physical principle that certain types of gases absorb certain wavelengths of infrared energy. In practice, a filament generates infrared energy, which concentrated, passes through the gas to be measured, and arrives at the detector. The detector is double, the first, defined as "active", has an optical filter, selective to the gas to be measured, while the second, called "reference" has a filter with a different wavelength. The active detector is used to detect the gas, while the reference detector provides the

"zero" value. The difference signal between the two detectors provides the value of the gas concentration. The advantage of this technique is that it is selective for gases such as carbon dioxide, which is difficult to measure with other methods, and also has the advantage of compensating, in time, the changes of detector sensitivity. The only interference, may be given from presence of water vapour, which absorbs infrared.

Preheating: when powered, the sensor needs a time of preliminary heating of about 60 seconds. During this period the yellow LED "FAULT" flashes. After this period, the yellow LED light off, the green LED "ON" illuminates to indicate normal functioning. After this period the unit is able to detect gas even if it attains the optimum stability conditions after about 10÷30 minutes continual functioning (only after this time, can be made the calibration check).

Normal operation: the green LED "ON" should be light on.

ALARMS: three alarm levels, can be set by Dip-Switch (see tables 2). There are two different alarm methods, the normal one, will activate the corresponding relays after a fixed delay, the advanced one, operate with TLV-TWA, STEL and C value, will activate the relays without delay.

The 1st red Led (ALARM 1) illuminates when the gas concentration attains 1st alarm level. Under normal alarm method, after about 12 seconds the "ALARM 1" relay will activate, while under advanced one, with TLV-TWA level selected, the relay will activate without delay.

The 2nd red Led (ALARM 2) illuminates when the gas concentration attains 2nd alarm level and after about 30 seconds, the "ALARM 2" relay will activate or without delay when TLV-STEL level is selected.

The 3rd red Led (ALARM 3) illuminates when the gas concentration attains 3rd alarm level and after about 60 seconds, the "ALARM 3" relay will activate or without delay when TLV-C level is selected.

TLV (Threshold Limit Values) are defined as an exposure limit to which it is believed nearly all workers can be exposed day after day for a working lifetime without ill effect.

TLV-TWA (Threshold Limit Value–Time-Weighted Average) is the time-weighted average concentration for a conventional 8-hour workday and a 40-hour workweek, to which it is believed that nearly all workers may be repeatedly exposed, day after day, without adverse effect.

TLV-STEL (Threshold Limit Value–Short-Term Exposure Limit) is the concentration to which it is believed that workers can be exposed continuously for a short period of time without suffering from irritation, chronic or irreversible tissue damage, or narcosis. STEL is defined as a 15-minute TWA exposure, which should not be exceeded at any time during a workday.

TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling) is the concentration that should not be exceeded during any part of the working exposure. The values are recommending exposure levels that are protective to workers, OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*, of the U.S. Department of Labour) and COSHH (*Control Of Substances Hazardous to Health in Europe*).

FAULTS: the Yellow LED (FAULT) illuminates, the "S" output falls down to 0mA (The different faults are listed below) and the "FAULT" normally activated relay (NC contact), will deactivate. The "FAULT" relay, if necessary, can be used both to signal remotely an occurred damage and to signal the absence of power to the instrument.

Yellow LED illuminates each 3 seconds (with green LED activate): this happens when the "Sensor" has overcome its period of life (about 5 years) and its correct operation is not longer guaranteed. The detector keeps on operating normally but it is necessary, as soon as possible, replace and / or send it back to the supplier to replace the "Sensor" with a new one.

Yellow LED activate, green LED off (FAULT relay activates and 0 mA output signal): this signal different kind of faults.
1) The Dip Switch set up is wrong, please verify (see Table 2). **2)** The "Sensor" is not working, (fault sensor or no communication or uncorrected). Performed the checks turn off then on the device. If the condition persists, please replace the unit and/or send it back to the supplier for repair.

Yellow and green LED activates (FAULT relay activates and 0mA output signal): this happens when the "Sensor" is not working. First try to turn off then on the device. If the condition persists, please replace the unit and/or send it back to the supplier for repair.

INSTALLATION

The detectors must be installed, positioned and carried out maintenance, following all the applicable national regulations for electrical installations and safety standards of the plant.

Mounting: The Fig. 1 shows the instrument size. The unit must be positioned vertically. The unit must be positioned vertically with the sensor downwards.

SE136 IC2 positioning: should be fixed at 20-30 cm from the floor (CO₂ gas is heavier than air).

Electrical Connection (see Fig.2): the maximum distance to install each detector from the from the power supply is show in table 1. If more than one detector is to be powered in parallel, it is necessary to consider the voltage drop across the supply cable. Normally use a two wire cable (not shielded) for power supply + the wire for output relays.

NOTE: If is also used the mA output signal, please use 3 wire shielded cable + conductors for relay output. The max load resistor is 50 ohm with 12Vdc power supply, while is 400 ohm with 24Vdc power supply (see fig.4).

Power Supply terminals, on the main board, are plug-in type, it is necessary to extract them to make the connection, pay attention when you insert them again, being polarized. The relays terminals, on outputs board, are fixed. The sealed relays are tension free SPST (Single Pole Single Throw) contacts and should be set NO (Normally Open) or NC (Normally Closed) by positioning the 4st Dip-Switch (see Table 3). With the Dip-Switches from 1 to 3 the concentration for alarm activations is determined. Alarms can be set with TLV-TWA and STEL functioning (see Table 2).

NOTE: Dip-Switch should be set with instrument powered off. Dip-Switch settled in reserved positions activates FAULT Led indication (see "Operational Description > Faults").

Important: Once installation is completed, power up the unit, it is not necessary to make any adjustment. Wait about 20 to 30 minutes and then, only if it is requested, carry out the "Operation Check" (see "Test").

WARNING

Average life: The sensitive element used in this detector has an excellent stability in time, the sensor's life is more than 5 years from the date of installation. After this period the yellow LED "FAULT" flashes every 3 seconds, this is only a warning, the detector continues to operate normally, but then is necessary replace and / or send the detector back to the supplier to replace the "Sensor" with a new one.

Periodical testing: depending on the use, we advise to carry out working tests every 6÷12 months. As explained in chapter "Tests". **For five years it is not necessary to calibrate the sensor.**

Note: the detector is not able to detect gas leaks occurring outside the room where it is installed, neither inside walls or under the floor.

Warning: Consider that in polluted environments or with temperature, pressure or Humidity more than the declared limits, the useful life of the sensor can be reduced.

TESTS

PAY ATTENTION: This procedure has to be made with extreme attention and by authorized and trained people; because will activate the alarm devices connected to the outputs (relays and mA signal).

Operation Check and Calibration check with Gas: are different code protected functions. To access these functions is necessary to insert the relevant "Code" through the keys F1 and F2. To have the key pressure recognized, hold pressing it for around a second (until the Green LED doesn't switch off for a moment). Then the next key can be pressed. In case of error all it takes is waiting around 10 seconds and the sequence is automatically erased.

Test Kit, Sample Gas Cylinders (only for Calibration Check) please, only using a mixture:

Sample Gas Cylinder for SPAN Calibration	Tecnocontrol Code
1% Volume Carbon dioxide (CO ₂) in nitrogen	Available on request
Sample Gas Cylinder for ZERO Calibration	
Pure Zero Air (less than 5 ppm CO ₂)	Available on request

You can use disposable cylinder, complete with adjust valve. It is also necessary to use the Test kit **Tecnocontrol model TC011 or TC014**.

"INSTRUMENT OPERATION CHECK" (Check Code: F2, F2, F1, F1): this function allows to effect a functional test of the equipment. After having inserted the "Check Code", all Led are switched off and all the relays are deactivated. Then they will switch on in sequence, the Led, from the yellow up to the 3rd red. To the lighting of the various Led it corresponds the activation of the relevant relays (relay "FAULT" with the yellow Led, relay "ALARM1" with the 1st red Led, relay "ALARM2" with the 2nd red Led, relay "ALARM3" with the 3rd red Led). At the end all the Led will remain lighted for around 5 seconds, then the detector returns at the conditions of normal operation. It is advisable to perform this operation every 12 months according to the use.

Note: this function is not working if the 1st and/or the 2nd and/or the 3rd red Led have already turned on.

"CALIBRATION CHECK WITH GAS" (no Code required): using the gas mixture indicated above, this function is used to control the correct response to the gas and can be made after the installation. But it should be done during the periodic maintenances, to verify the effective functioning of the detector.

NOTE: please use, the gas mixture as indicated above. Normally it is sufficient to perform the **Calibration check with gas**, (1%Volume CO₂ Cylinder in nitrogen) but you can also carry out **Checking Zero** (Pure Zero Air Cylinder).

Insert the TC011/TC014 over the sensor holder, adjust the sample gas bottle valve as the flow meter indicates around 0.3 l/mins (see Fig.3), wait for 3 minutes and check that the instrument activates Alarms as shown in chapter "Operational Description". If the result is very different, contact our customer service. Then close the gas bottle, remove TC011/TC014. The detector will slowly returns at the conditions of normal operation.

NOTE: further to the above, if the mA output is also used, insert the TC011/TC014 over the sensor holder, adjust the sample gas bottle valve as the flow meter indicates around 0.3 l/mins (see Fig.3), verify with a voltmeter connected to the Test-Point "TEST mV" (TP1 and TP2), (see fig.2) the value reach the mV value as shown in Table 4 on column 6 [corresponding to mA output value (±0.56 mA) as indicated in column 7. The central unit should be display about the value indicated in column 8]. If the result is very different, contact our customer service. Then, close the gas bottle; move away the TC011/TC014. Then, the mA output will slowly decrease up to 4mA.

Example if you have to verify a SE136 IC2 using a cylinder with Pure Zero Air, the mA output will be 4.0 mA (corresponding about to 40 mV measured on "TESTmV"). Then using a cylinder with 1%volume (= 10000 ppm) CO₂ in nitrogen, the mA output will be approximately 12.0 mA (±0.56mA) (corresponding value from 114 to 126mV measured on "TESTmV").

FR DESCRIPTION

Les SE136 IC2 sont des sondes de détection de CO₂, avec capteur "Infrarouge" (NDIR – Nondispersive Infrared Sensor), utilisées dans les systèmes centralisés de détection de gaz destinés pour la première aux alarmes pour laboratoires, industries alimentaires, caves vitivinicoles et brasseries et pour la seconde aux contrôles de la quantité d'anhydride carbonique présente dans les serres. La sonde est constituée d'un boîtier contenant le circuit électronique ainsi que les borniers de raccordement. Le capteur est à l'intérieur du porte capteur, dans la partie inférieure du boîtier.

Le **SE136 IC2** possède 3 relais d'alarmes réglables, intervenant comme indiqué aux [Tableaux 2](#) et 1 relais de dérangement. Les relais, possèdent un contact libre de tension. En outre un signal de sortie (**S**) 4÷20mA linéaire avec fin d'échelle du gaz mesuré ([comme indiqué sur la page 1](#)). Cette sortie peut être utilisée pour se raccorder sur une installation centralisée et/ou pour effectuer les opérations de vérification en utilisant par codes, les touches F1 et F2, placés sur la carte de circuit imprimé, sur lequel il ya 5 leds indiquant les conditions de fonctionnement:

Signalisations et commandes:

3° led rouge "ALARM" 3:	relais d'alarme ALARM 3.
2° led rouge "ALARM" 2:	relais d'alarme ALARM 2.
1° led rouge "ALARM" 1:	relais d'alarme ALARM 1.
led verte "ON":	Fonctionnement normal.
led jaune "FAULT":	Capteur en panne ou déconnecté ou échu.

NOTES SUR LES DIFFERENTS MODELES

Le **SE136 IC2** est calibré avec fond d'échelle à **2%vol** soit 20000ppm de CO₂.

L'**anhydride carbonique** (synonyme: bioxyde de carbone), est un gaz inodore et incolore, plus lourd que l'air puisque sa densité relative à celui-ci est 1,5 a par conséquent, tendance à s'accumuler en partie basse des ambiances en générant une dangereuse carence en oxygène. Sa **TWA** (Time-Weighted Average) est de **5000ppm = 0,5%vol** et sa **STEL à 15000ppm = 1,5%Vol** (Short Term Exposure Limit).

L'anhydride carbonique est un composant fondamental de l'atmosphère terrestre, sa quantité en air pur est d'environ 400 ppm et il est indispensable au processus vitaux des plantes (photo synthèses) et des animaux, mais c'est également pour l'atmosphère, un gaz à effet de serre. L'anhydride carbonique est produit par les processus de combustion des énergies fossiles (centrales électrothermiques et automobiles), comme sous-produit résultant des fermentations (vin, bière, biomasse) ou bien émis par des processus naturels et d'exhalaison du sol. Il est utilisé dans le secteur agricole et dans la floriculture en apport, en serres, afin d'augmenter la croissance des plantes, etc....

FONCTIONNEMENT

Le capteur NDIR est compensé en température, peut être utilisé en ambiances polluées sans enregistrer de dégradation sensibles de ses prestations même à long terme et il fonctionne également dans les ambiances carencées en oxygène.

Le principe de fonctionnement du capteur NDIR se base sur le principe physique d'absorption par certains types de gaz de longueurs d'ondes déterminées d'énergie infrarouge.

En pratique, un filament génère le faisceau infrarouge qui, concentré, passe à travers le gaz à mesurer et est renvoyé à la détection. Le capteur est double, l'une, défini comme actif, à un filtre optique pour le gaz spécifique à détecter, l'autre, dite de référence, comporte un filtre de longueur d'onde différente et servant de référence.

La différence entre ces deux signaux permet de mesurer la concentration de gaz. L'unique cause d'interférence peut être donnée par la présence de vapeur d'eau, qui absorbe l'infrarouge.

Préchauffage: à partir du moment où la sonde est alimentée commence le préchauffage du capteur, signalé par le clignotement de la led jaune "FAULT". Après environ 60 secondes, la led jaune s'éteint et la led verte "ON" s'allume, indiquant un fonctionnement normal. A partir de ce moment, la sonde est en mesure de détecter le gaz, mais elle n'atteindra les conditions de stabilité optimales qu'après 10÷30 minutes de fonctionnement continu.

Fonctionnement normal: seule la led verte (ON) doit rester allumée.

Le 1^{ère} led rouge, ALARM 1 s'allume si la concentration de gaz dépasse le premier seuil, si la concentration se maintient environ 12 secondes, le 1^{er} relais ALARM 1 intervient. En outre avec la méthode avancée il intervient sans retard quand le niveau TLV-TWA est dépassé.

Le 2^{ème} led rouge, ALARM 2 s'allume si la concentration de gaz dépasse le second seuil, si la concentration se maintient environ 30 secondes, le 2^{ème} relais ALARM 2 intervient. En outre avec la méthode avancée il intervient sans retard quand le niveau TLV-STEL est dépassé.

Le 3^{ème} led rouge, ALARM 3 s'allume si la concentration de gaz dépasse le troisième seuil, si la concentration se maintient environ 60 secondes, le 3^{ème} relais ALARM 3 intervient. En outre avec la méthode avancée il intervient sans retard quand le niveau TLV-C est dépassé.

TLV (threshold limit values) ce sont les valeurs limites d'exposition aux substances polluantes auquel les travailleurs puissent être exposés chaque jour durant leur travail sans effets nuisibles.

TLV-TWA (time weighted average) c'est la concentration moyenne pondérée dans le temps pour une journée ouvrable normale de 8 heures et une semaine de travail de 40 heures durant laquelle les travailleurs peuvent être exposés sans effets nuisibles.

TLV-STEL (short time exposure limit) c'est la limite d'exposition durant une brève période c'est-à-dire la concentration durant laquelle les travailleurs peuvent être exposés continuellement pendant 15 minutes, sans subir d'irritations, de dommages chroniques irréversibles ou de narcose.

TLV-C (Ceiling) c'est la limite maximale de concentration à ne jamais dépasser. Les valeurs indiquées sont rapportées aux prescriptions des organismes s'occupant de la santé des travailleurs, l'OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*) américain et le COSHH (*Control Of Substances Hazardous to Health*) européen.

Dérangement: La centrale signale les anomalies, décrites ci-dessous, en allumant la led jaune (FAULT), en portant la sortie "S" à 0mA. et en activant le 4^{ème} relais "FAULT" qui est normalement excité avec un contact normalement fermé NF libre de tension. Si demandé, il peut être utilisé pour signaler à distance la condition de dérangement ou le manque d'alimentation.

La led jaune s'allume chaque 3 secondes (avec la led verte allumée): pour aviser que le "capteur" a dépassé sa durée de vie (environ 5 ans) et que son fonctionnement correct n'est plus garanti. La sonde continue à fonctionner normalement, mais il est nécessaire, au plus vite de substituer et/ou renvoyer la sonde au fournisseur pour remplacer le "capteur".

La led jaune est allumée et la verte est éteinte (relais "FAULT" activé et sortie 0mA): cet état indique plusieurs possibilités de dérangements.

1) la configuration des Dip Switch n'est pas correcte, vérifier la position ([Voir Tableau 2](#)).

2) le "capteur" est en panne (panne du capteur ou communication absente ou incorrecte). Faire les vérifications, couper puis rétablir l'alimentation de l'appareil. Si les conditions persistent, substituer et/ou renvoyer la sonde au fournisseur pour réparation.

La led jaune et la verte sont allumées (relais "FAULT" activé et sortie 0mA): le "capteur" est bloquée ou en panne. Éteindre puis réalimenter l'appareil. Si les conditions persistent, substituer et/ou renvoyer la sonde au fournisseur pour réparation.

INSTALLATION

Les sondes doivent être installées, positionnées et les mise en services et maintenances exécutées dans le respect de toutes les normes nationales en vigueur concernant les installations électriques ainsi que les normes de sécurité des installations.

Montage: en [Fig. 1](#) sont indiquées les dimensions. La sonde s'installe verticalement. Le détecteur doit être monté en position verticale avec le capteur tourné vers le bas.

Position du SE136 IC2: il doit être fixé à environ 20-30cm du plancher (le CO₂ étant beaucoup plus lourd que l'air).

Raccordements électriques ([Fig.2](#)): la distance maximale à laquelle chaque détecteur peut être alimenté est indiquée dans le [Tableau 1](#) en fonction de la section du câble utilisé. Dans le cas d'alimentation de plusieurs détecteurs en parallèle, il est nécessaire de calculer la chute de tension sur les portions communes des câbles. Un câble sans écran est normalement utilisé, avec 2 conducteurs pour l'alimentation + les conducteurs pour les sorties relais.

NOTA: Dans le cas où l'on utilise également le signal de sortie en 4÷20 mA, il convient d'utiliser des câbles à écran à 3 conducteurs + les conducteurs pour les sorties relais. Si l'on utilise une alimentation 12Vcc la résistance maximale de charge (RL) sera de 50 Ω, si on utilise une alimentation 24Vcc la RL sera de 500 Ω ([Fig.4](#)).

Les borniers d'alimentation sont situés sur la carte principale et sont de type "brochable", et il est nécessaire de le débriquer pour effectuer les connexions. Par contre ceux des relais d'alarmes, montés sur la carte de sortie, sont fixes. Les relais, de type solide state, possèdent un contact libre de tension, (SPST = 1 Unique Contact / Single Pole Single Throw), qui peut être paramétré NA=NO (Normalement Ouvert) ou NC=NF (Normalement Fermé) selon position du Dip-Switch n°4 ([Tableau 3](#)). Les Dip-Switch de 1 à 3 servent à déterminer les seuils d'alarmes en fonction des concentrations ([Tableau 2](#)).

Remarque: Les Dip-Switch doivent être positionnés avant d'alimenter le détecteur. Si on utilise le détecteur avec les Dip-Switch dans une position réservée l'indication de Dérangement sera activée. (Voir "Fonctionnement> Dérangement").

Important: une fois l'installation terminée, alimenter la sonde, il n'est pas nécessaire d'effectuer de réglage puis attendre environ 20÷30 minutes avant d'effectuer, si demandé les "Vérifications de fonctionnement".

AVERTISSEMENTS

La vie utile du capteur est en moyenne de plus de 5 ans. Au terme de cette période, indiqué par le clignotement de la led jaune chaque 3 secondes, il est nécessaire de renvoyer la sonde au fournisseur pour remplacer le "capteur". (La led clignotant ne est qu'un avertissement, le détecteur continue à fonctionner normalement).

Vérifications périodiques: il est conseillé d'effectuer, en fonction des conditions d'utilisation, au minimum tous les 12 mois, la vérification du fonctionnement de la sonde, voir la section "Vérifications". **Pendant cinq ans, ne est pas nécessaire d'étalonner le capteur.**

Nota: la sonde n'est pas en mesure de détecter du gaz hors du local dans lequel elle est installée ou à l'intérieur des murs ou sous le plancher.

ATTENTION: Considérer qu'en ambiance particulièrement polluée, ou bien en cas de température, pression ou hygrométrie supérieures au standard, la vie utile du capteur peut être réduite.

VERIFICATIONS

NOTA IMPORTANT: les opérations suivantes ne doivent être exécutées que par un personnel compétent et autorisé, car les sorties relais fonctionneront en provoquant l'activation des asservissements qui leurs sont connectés.

Test électrique et Vérification: pour accéder à ces fonctions, il est nécessaire d'insérer le "Code" à l'aide des touches F1 et F2. Pour que la pression soit reconnue, tenir la touche appuyée durant environ une seconde (jusqu'à ce que s'éteigne un instant la led verte). Passer ensuite à la touche successive. En cas d'erreur, il suffit d'attendre environ 10 secondes et la séquence est automatiquement effacée.

Kit de vérification et bouteilles avec mélange air/gaz (pour vérification): le mélange à utiliser est:

Bouteille de gaz titré pour calibration FS		Code Bouteille
1% Vol	anhydride carbonique (CO ₂) en azote	Fourni sur demande
Bouteille de gaz titré pour calibration du zéro		
air zéro pur (avec moins de 5ppm CO ₂)		Fourni sur demande

Il est possible d'utiliser des bouteilles mono-usage équipées de vannes de distribution, il convient, en outre d'utiliser le kit de vérification **Tecnocontrol modèle TC011 ou TC014**.

“TEST ELETTRIQUE” (Code Test: F2, F2, F1, F1): permet d'effectuer un test fonctionnel de la sonde. Après avoir mis l'installation en sécurité et avoir inséré le **“Code Test”**, toutes les leds s'éteignent et tous les relais se désactivent. Ils s'allumeront ensuite en séquence, de la led jaune jusqu'à la 3^{ème} led rouge. À l'allumage des différentes leds correspond l'activation des relais relatifs (relais "FAULT" avec la led jaune, relais "ALARM1" avec la 1^{ère} led rouge, relais "ALARM2" avec la 2^{ème} led rouge, relais "ALARM3" avec la 3^{ème} led rouge). À la fin toutes les leds resteront allumées pendant environ 5 secondes, puis le détecteur reviendra dans les conditions de fonctionnement normal. Il est souhaitable d'exécuter cette opération tous les 12 mois en fonction de l'utilisation.

Nota: Il n'est pas possible d'exécuter l'opération si la 1^{ère} et/ou la 2^{ème} et/ou la 3^{ème} leds rouges sont déjà allumées.

“VERIFICATION” (Le Code ne sert pas): cette fonction permet la vérification du fonctionnement correct du détecteur avec le mélange de gaz prévu. La vérification doit être exécutée après l'installation ou pendant les entretiens périodiques, étant donné qu'il s'agit de la seule méthode permettant de contrôler la fonction effective du détecteur.

NOTA: utiliser le mélange de gaz comme indiqué ci-dessus. Normalement, il suffit d'effectuer la **vérification de l'éta-lonnage**, (Bouteille de gaz 1% Volume de CO₂ en azote), mais vous pouvez également effectuer la **Vérification zéro** (Bouteille de air zéro pur).

Coiffer la tête de détection avec le TC011/TC014, régler le détendeur de la bouteille de façon à ce que le débit-mètre indique 0.3 l/min (Fig.3) et contrôler que le détecteur parte en alarme comme décrit dans le chapitre "Fonctionnement". *Si le résultat est très différent, contactez notre service.* Une fois terminé la **“Vérification”**, ôter le TC011/TC014. Le détecteur reviendra dans les conditions de fonctionnement normal.

NOTE: En outre si la sortie en 4÷20 mA est utilisée, Coiffer la tête de détection avec le TC011/TC014, régler le détendeur de la bouteille de façon à ce que le débitmètre indique 0.3 l/min (voir Fig.3). Contrôler, avec les pointes de touche du voltmètre que sur les Test-Point **“TEST mV”** (TP1 et TP2), (voir Fig.2) on obtient la valeur en mV indiquée au **Tableau 4-Colonne 6**. [ou bien que la sortie en mA augmente jusqu'à la valeur indiquée dans la **Colonne 7** (±0,56mA) et que la centrale, à laquelle est raccordée la sonde, indique la valeur contenue en **Colonne 8**]. *Si le résultat est très différent, contactez notre service.* Une fois la **“Vérification”** terminée, fermer la bouteille et enlever le kit TC011/TC014. La sortie revient ensuite à 4 mA.

Exemple: on doit vérifier une sonde SE136 IC2 calibrée avec FS (fond d'échelle) 2%vol (=20000ppm) de CO₂, en utilisant la bouteille avec Air Zéro Pur, la sortie en mA doit être environ 4,0 mA (ou bien environ 40 mV sur **“TESTmV”**) puis en utilisant la bouteille avec CO₂ à 1%vol (=10000ppm) en azote, la sortie en mA doit être environ 12,0 mA (±0,56mA) (ou bien environ 114÷126 mV sur **“TESTmV”**).

Tabella 1 / Table 1 / Tableau 1

Sezione Cavo Cable Size Section des câbles	Resistenza Cavo [Singolo Conduttore] Cable Resistance [Single wire] Résistance câbles [par Conducteur]	La massima distanza, cui può essere installato ogni rivelatore dall'alimentatore a 12Vcc The maximum distance to install each detector from the 12Vdc power Supply Distance max d'installation du détecteur sous 12Vcc	La massima distanza, cui può essere installato ogni rivelatore dall'alimentatore a 24Vcc The maximum distance to install each detector from the 24Vdc power Supply Distance max d'installation du détecteur sous 24Vcc
0,75 mm ²	26 Ω/km	100 m	300 m
1 mm ²	20 Ω/km	150 m	400 m
1,5 mm ²	14 Ω/km	200 m	500 m
2,5 mm ²	8 Ω/km	400 m	800 m

Tabella 2 / Table 2 / Tableau 2

“S1-SET” (Dip-Switch)			Livelli Allarme (Relé) Alarm levels (Relays) / Niveau d'alarme (Relais)			Ritardo dei Relé (Secondi) Relays Delay (Seconds) / retarde du relais (Secondes)			
1	2	3	ALARM 1	ALARM 2	ALARM 3	ALARM 1	ALARM 2	ALARM 3	FAULT
OFF	OFF	OFF	0,20	0,50	1,00	12	30	60	30
ON	OFF	OFF	0,50	1,00	1,50	12	30	60	30
OFF	ON	OFF	1,00	1,50	2,00	12	30	60	30
ON	ON	OFF	0,80	1,60	1,80	12	30	60	30
OFF	OFF	ON	TLV-TWA ^(COSHH) 0,50	TLV-STEL ^(COSHH) 1,50	TLV-C 2,00	0	0	0	0
ON	OFF	ON	Risevato / Reserved / Réserve			Risevato / Reserved / Réserve			
ON	ON	ON	Risevato / Reserved / Réserve			Risevato / Reserved / Réserve			

COSHH= Ente Europeo / **OSHA** =Ente Americano

Tabella 3 / Table 3 / Tableau 3

“S1-SET” (Dip-Switch)	Contatti Relé Allarme Relays contacts (SPST) Contacts Relais			
4	ALARM 1	ALARM 2	ALARM 3	FAULT
OFF	NA / NO	NA / NO	NA / NO	NC / NF
ON	NC / NF	NC / NF	NC / NF	NC / NF

Il Dip-Switch va posizionato prima d'alimentare l'apparecchio.

Dip-Switch should be set with instrument powered off.

Les Dip-Switch doivent être paramétrés avant d'alimenter le détecteur

Tabella 4 / Table 4 / Tableau 4

1	2	3	4	5	6	7	8
Modello e Gas Rilevato Model and detected Gas Modèle et Gaz détecté	Campo di misura Standard Range Champ de mesure	Densità / Density / Densité Aria / Air = 1 [NOTA⁽¹⁾] NOTE⁽¹⁾/ REMARQUE⁽¹⁾	Gas Bombola Gas bottle Bouteille de gaz titré	Flussometro Flowmeter Débitmètre	TESTmV (TP1/TP2) mV	Uscita Output Sortie	Indicazione indication Indication
SE136 IC2 Anidride carbonica Carbon Dioxide / Dioxyde de carbone	0÷2% vol	1.5 ↓	0	0.5 l/min	40	4,0 mA	0% vol
			1% vol		120	12 mA	1% vol
			2% vol		200	20 mA	2% vol

NOTA⁽¹⁾ / NOTE⁽¹⁾ / REMARQUE⁽¹⁾ Densità dei Vapori riferita all'Aria / Vapor Density as to air / densité par rapport à l'air.
 ↓ = Gas più pesante dell'aria / Gas heavier than air / gaz plus lourd que l'air.

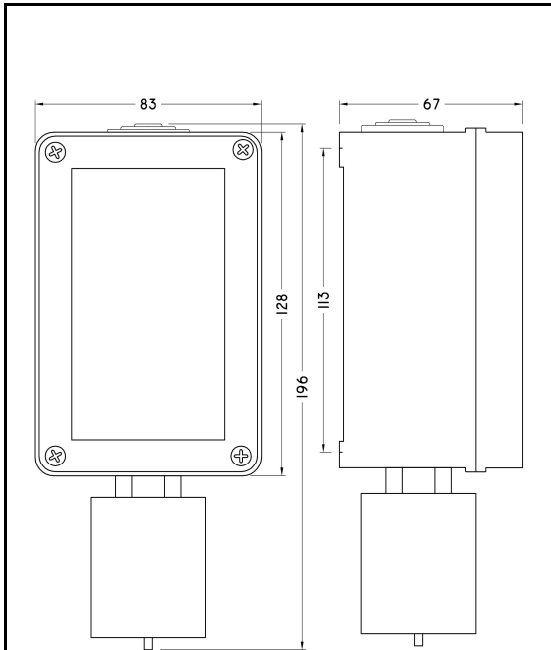


Fig. 1 - Dimensioni / Size / Dimensions

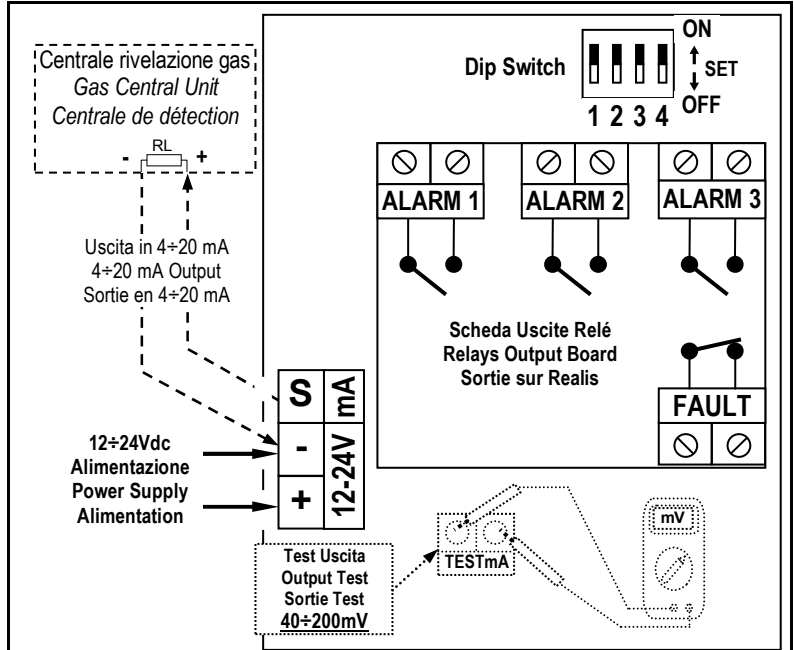


Fig. 2 - Schema di collegamento / Wiring diagram / Schéma

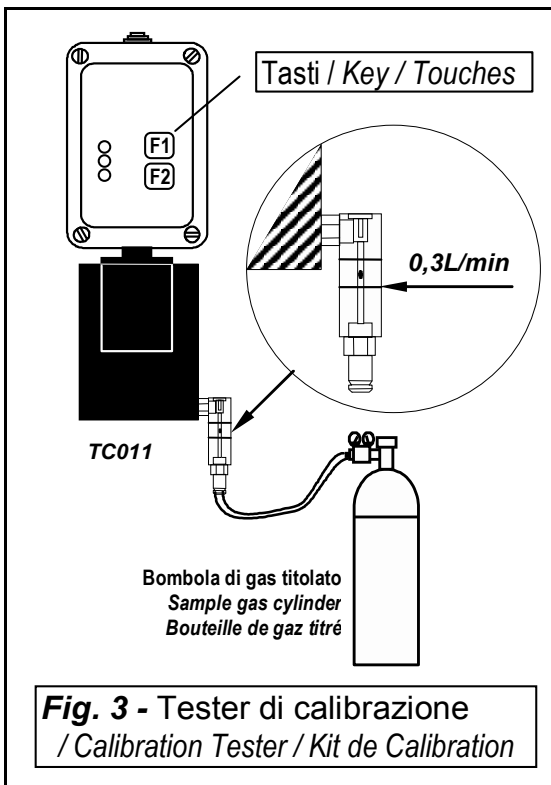


Fig. 3 - Tester di calibrazione / Calibration Tester / Kit de Calibration

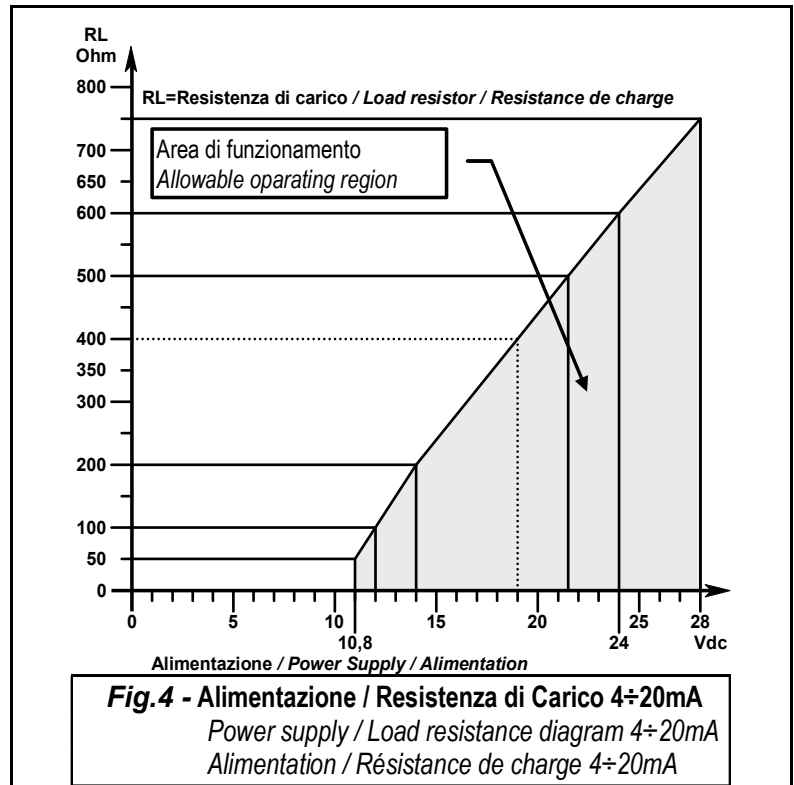


Fig. 4 - Alimentazione / Resistenza di Carico 4±20mA
 Power supply / Load resistance diagram 4±20mA
 Alimentation / Résistance de charge 4±20mA